


Quota X	Q.tà
0,036 mm	500
0,05 mm	800
0,10 mm	700
0,19 mm	300

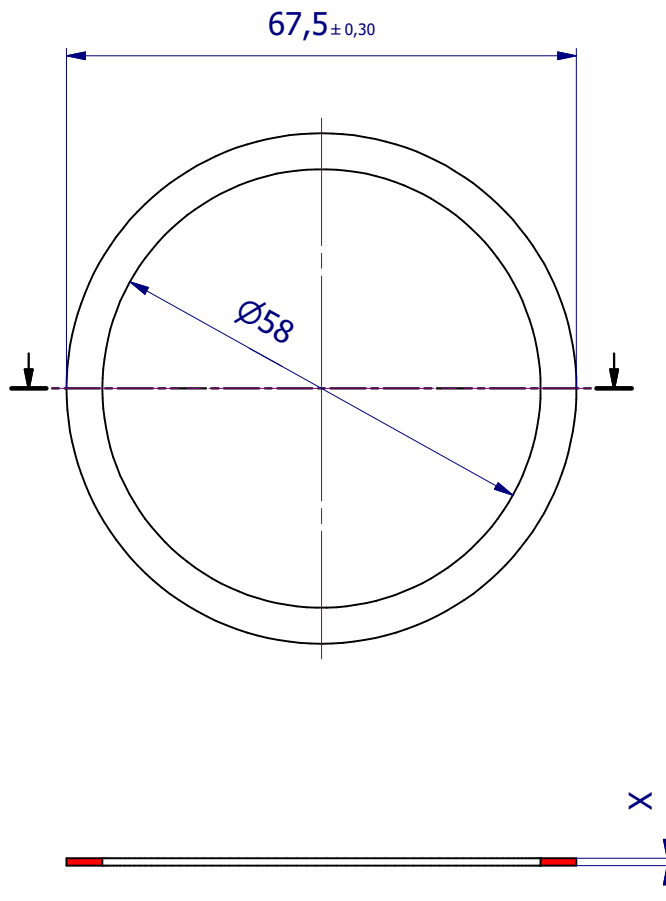

CODICE DISEGNO SAM-001-014			<div></div> <div>INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA RADIOTELESCOPIO MEDICINA Via Fiorentina 3508/B - 40060 Villafontana (BO) Tel. 051 6965811 Fax 051 6965810</div>		
SOSTITUISCE DIS. N. -					
MATERIALE Mylar			DENOMINAZIONE Radiotelescopio di Medicina 32m Superficie attiva - Attuatore Rondella spessorazione Mylar		DISEGNATORE J. Roda
TRAT. TERM. -					CONTROLL. J. Roda
SCALA DIS. -	SCALA PLT. -	QUANTITA' Vedi tabella	DIMENSIONI SENZA TOLLERANZA Foro=H11 Albero=d11 SPIGOLI NON QUOT.Sm 1x45° RACCORDI NON QUOT.R=0.5		<div></div> <div>DATA 08/03/2019</div>
L'INAF SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE					