


N° 16
Anelli/occhielli per tesaggio telone
Nichelati VL80

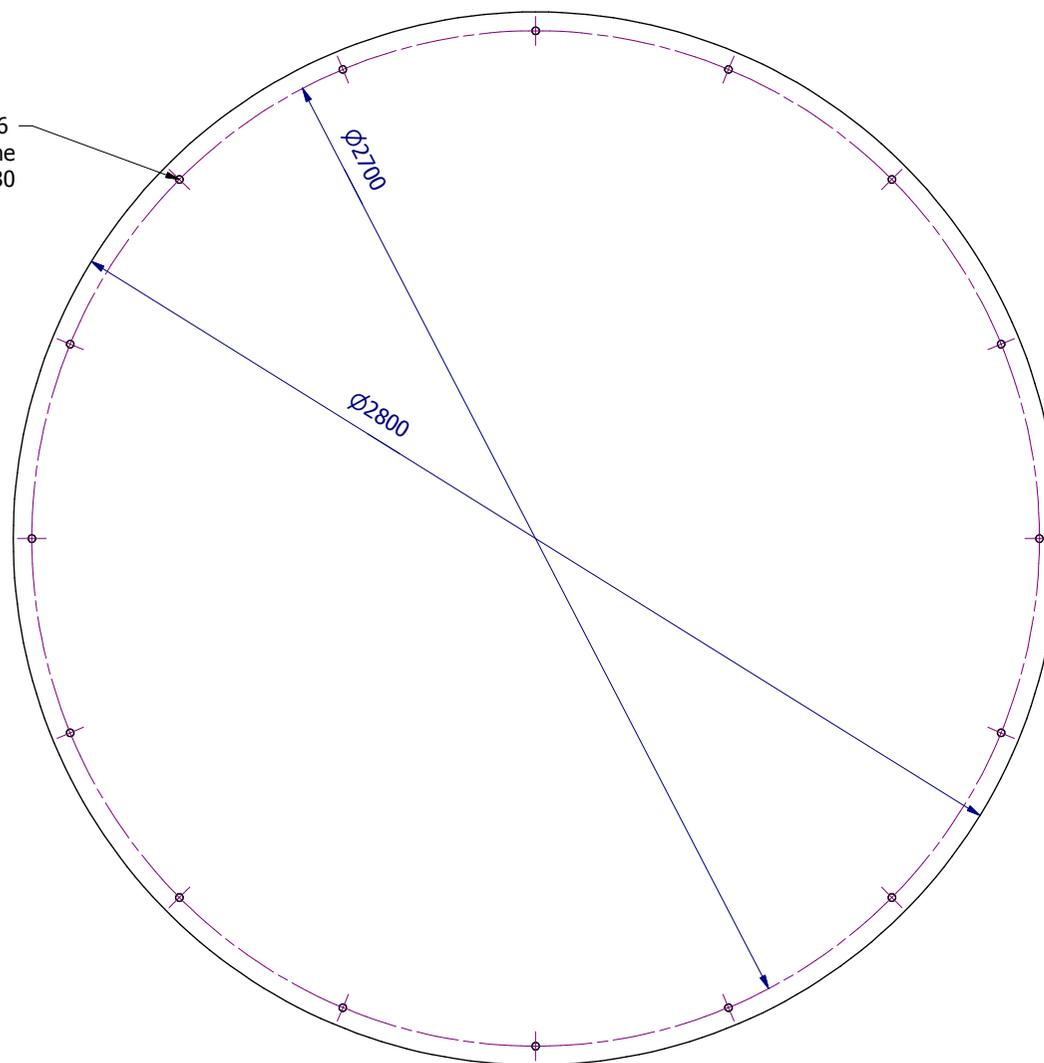

Materiale:
Tessuto poliestere impermeabilizzato con
spalmatura di PVC su entrambe le faccie con
colore bianco traslucido

CODICE DISEGNO MED-DWG-GORE-02			 INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA RADIOTELESCOPIO MEDICINA Via Fiorentina 3508/B - 40060 Villafontana (BO) Tel. 051 6965811 Fax 051 6965810		DISEGNATORE J. Roda	
SOSTITUISCE DIS. N.					CONTROLL. J. Roda	
MATERIALE Vedi nota sul disegno			DENOMINAZIONE Radiotelescopio di Medicina 32m		DISEGNATORE J. Roda	
TRAT. TERM.			Chiusura Vertex Finestra in poliestere e PVC spalmato		CONTROLL. J. Roda	
SCALA DIS.	SCALA PLT.	QUANTITA' 1	DIMENSIONI SENZA TOLLERANZA Foro=H11 Albero=d11 SPIGOLI NON QUOT.Sm 1x45° RACCORDI NON QUOT.R=0.5		 DATA 09/05/2016	
L'INAF SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE						